

Magellan – Faisabilité

**Magellan - Appareil de neurostimulation
électrique transcutanée**

Magellan - Neurostimulation

Magellan - Appareil de neurostimulation électrique transcutanée

- **Etape 1 : Une étape de faisabilité MAGELLAN**

- Elle a pour Objectif d'anticiper la faisabilité d'une étape 2 (Protocole CESREES) afin de valider le bon enregistrement des consommations de soins directs, en lien avec VITALITENS, approcher le nombre de patients impliqués (prévalence / incidence), une caractérisation de cette population : genre, pyramide des âges, et ce depuis la prise en charge définie par le JO d'Octobre 2022.

- **Pour cela l'étude construira sa population d'analyse en se basant sur la codification spécifique à VITALENS :**


- [1172460 - NEUROSTIM ÉLEC TRANSCUTANÉE, EXPANSCIENCE, VITALITENS, LOC. MENSUELLE DE L'APPAREIL](#)
- [1188840 - NEUROSTIM ÉLEC TRANSCUTANÉE, EXPANSCIENCE, VITALITENS, ACHAT DE L'APPAREIL](#)
- [1147596 - NEUROSTIM ÉLEC TRANS, EXPANSCIENCE, VITALITENS, ÉLECTRODES SOUPLES AUTOCOLLANTES L4](#)
- [1138232 - NEUROSTIM ÉLEC TRANS, EXPANSCIENCE, VITALITENS, CÂBLES DE STIMULATION, LOT DE 2](#)
- [1176899 - NEUROSTIM ÉLEC TRANS, EXPANSCIENCE, VITALITENS, PRESTATION, INITIATION](#)

- **A l'issue de cette Etape1, l'Etape 2 pourra être envisagée : Un projet d'étude descriptive MAGELLAN à visée CESREES :**


- Ce projet descriptif, au-delà des analyses descriptives des populations prévalentes et incidentes, visera tout particulièrement à décrire les points suivants :
 - Enregistrer la consommation d'antalgiques « avant – pendant et éventuellement après » la prise en charge par VITALITENS
 - Enregistrer le Taux de Transformation « Location -> achat », à l'issue de la phase d'essai décrite par la HAS
 - Enregistrer le respect des conditions de Prescription, le bon usage, la compliance et approcher un taux de répondants, toujours au regard des conditions édictées dans l'avis de la HAS
 - Objectiver le recours ou non à la chirurgie, après la mise en place d'un traitement par VITALITENS.

Magellan - Neurostimulation

Magellan - Appareil de neurostimulation électrique transcutanée

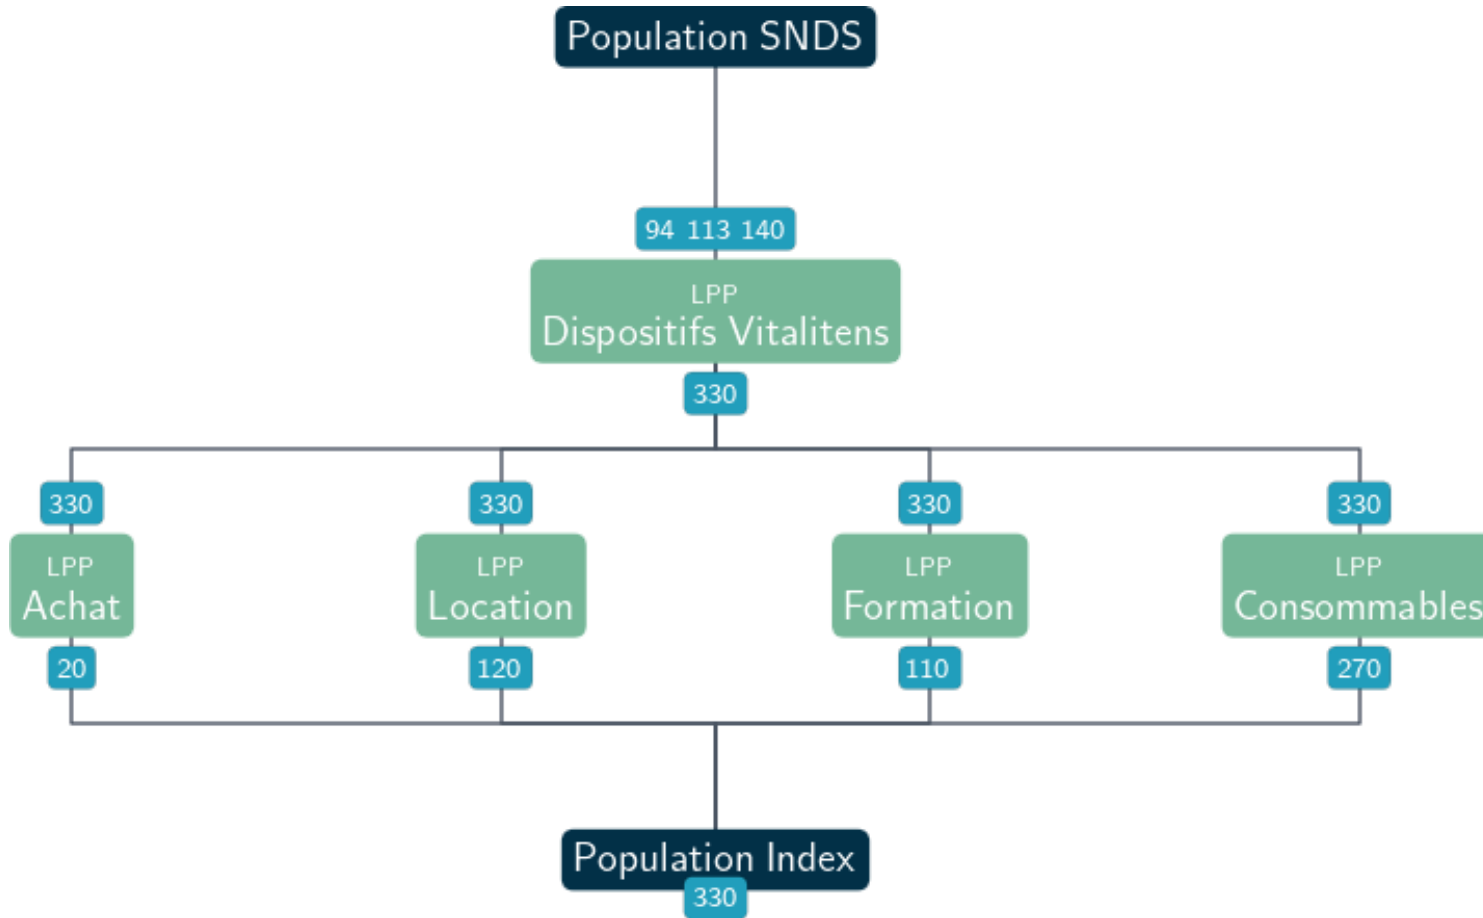

Répartition par sexe (population)

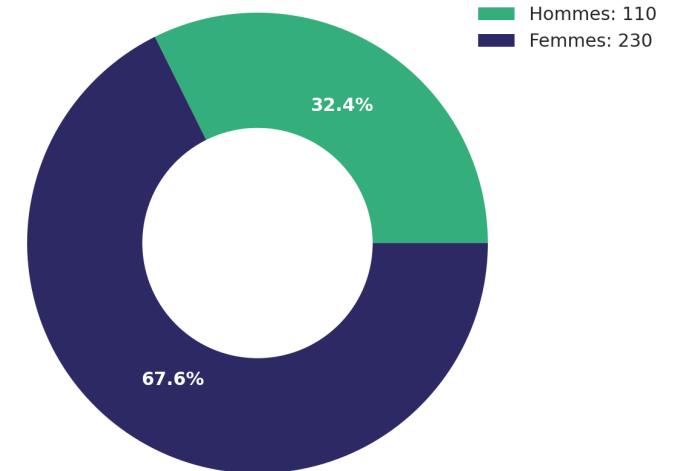

Magellan - Neurostimulation

Résultats de l'étude de faisabilité

- L'étude de faisabilité a été réalisée courant 2023, soit sur Pack de données 2022 : soit +/- 3 mois après la prise en charge collectivité (LPP – Octobre 2022), les résultats sont donc à ce stade indicatif
- **Pour cela l'étude construira sa population d'analyse en se basant sur la codification spécifique à VITALENS :**
 - Identification OUI / Comptages indicatifs
- Cette étude de faisabilité « Magellan – Neurostimulation » sera à reproduire sur les données 2023 / 2024 pour assurer la véracité des données produites